

KALIBRERINGSKORT


Tag no. **LT01**
 Beskrivelse : Nivåtransmitter tank H-10

Fabrikat : **Rosemount**
 Type : **1151 DP4 E**

Område (max) : **380 mbar**
 Kalibrert : **0 – 196 mbar**


Temp.; **20 °C** g : **9,81**
 Atmosfæretrykk : **1 atm.**

Dato : _____
 Signatur : _____

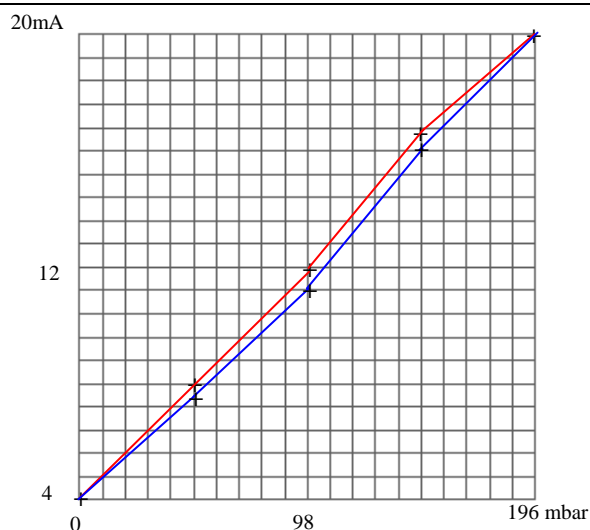

Korreksjon/kalibreringskurve

Måleoppsett

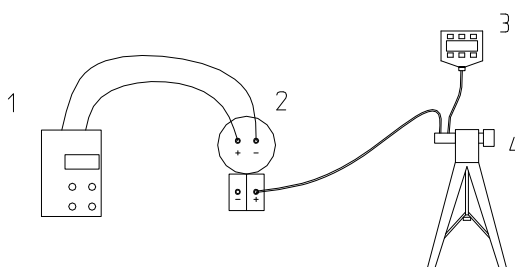

Tegn ref	Beskrivelse	Tag nr.	Serienr.	Dato kal.
1	Loop calibrator: Unomat UPS II	LC5	18768	16.03.07
2	DP-celle	LT01		
3	Manometer: Scan sense PM-199-PIC		16015	25.09.07
4	Pumpe: Beamex			

KONTROLLERT

0	25	50	75	100	%
0	49	98	147	196 mbar	Inn
4	8	12	16	20 mA	Ut bereg.
					Ut opp
					Ut ned

KALIBRERT

4	7,08	11,2	16,06	20	Ut opp Blå
4,01	8,03	12,12	16,8	20	Ut ned Rød